

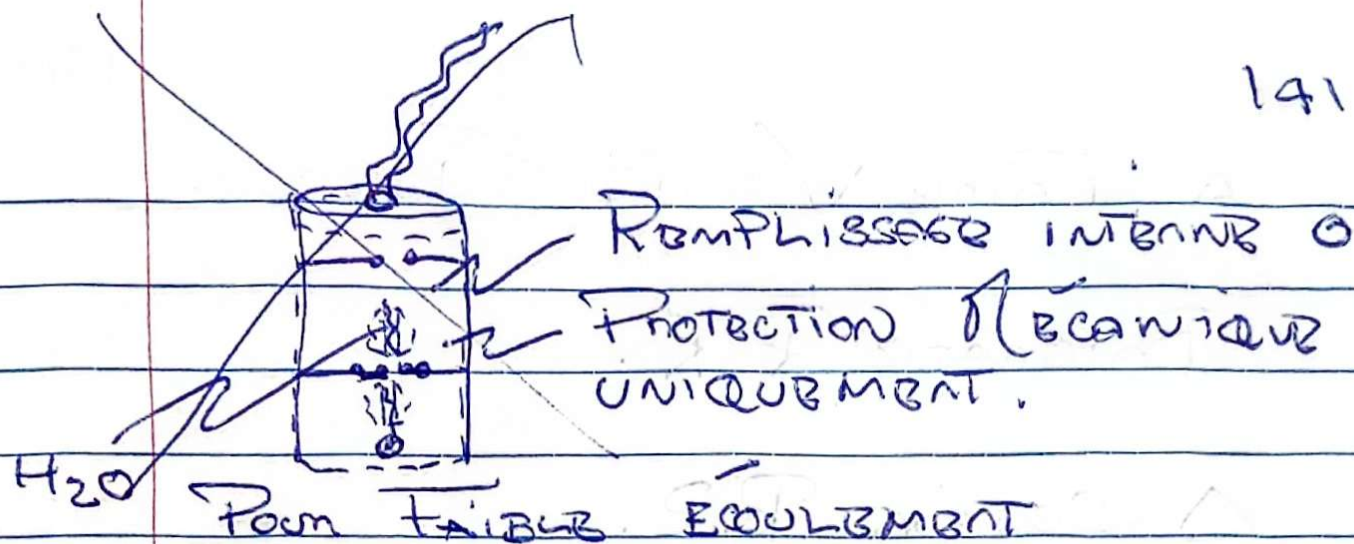


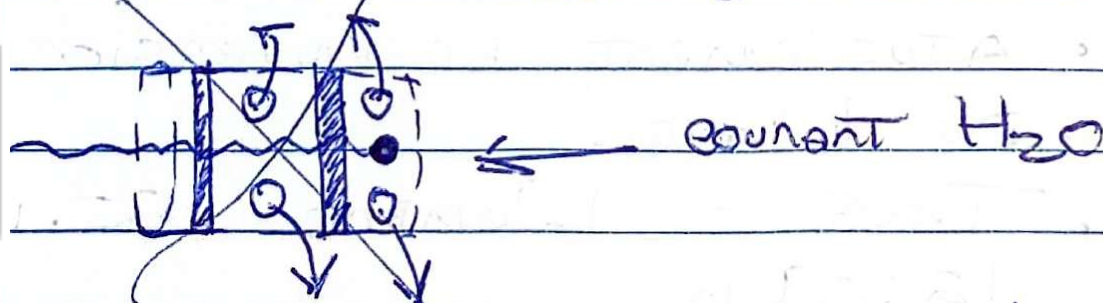


T° H₂O connect en fonction
DE L'INSTRUMENT Pour L'INSTANT
(29.5°C) RDI S102
VALIDE H₂O TEMP EXT.

• NOUVELLE SONDE H₂O ↑ + TEMP EXT ↑



ET Procédure ÉCHANTILLONNAGE

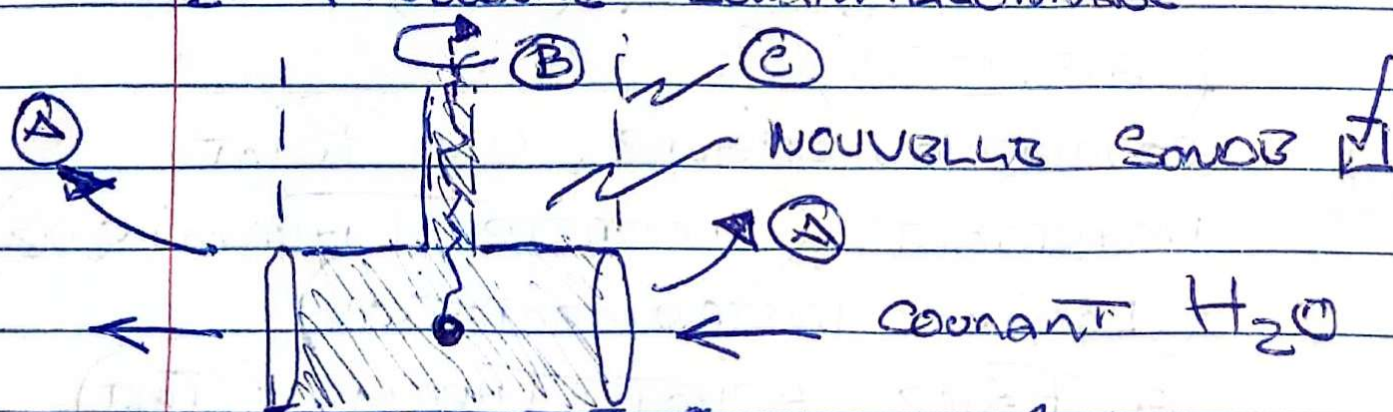

Brevet ? Pierre (le) (Bodan - A tml)